

# GIMA Fetalni džepni dopler - proizveden u U.K.



29503

## CODE 29502 GIMA FOETAL DOPPLER G2002

Mali, lak, visoko senzibilan džepni Doppler, sa fetalnom sondom od 2MHz, idealan za lekare i babice za rutinsku prenatalnu detekciju.

Džepni Doppler se koristi za detekciju srčanog rada fetusa od 10 nedelje trudnoće. Može se koristiti za lociranje položaja placente, što omogućava rano dijagnostifikovanje placenta praevia, zatim praćenje protoka krvi kroz pupčanu vrpcu kao i dijagnostifikovanje višestruke trudnoće. Fetalni signali se lako lociraju koristeći laki uski svetleći transformator dok su zvučni artefakti proizvedenog ultrazvučnog signala minimizirani. Audio signali srca fetusa korisnik može čuti preko ugrađenog zvučnika ili opcije za slušalice, jačina zvuka se povećava obrtnim tasterom za kontrolu zvučnosti.

## CODE 29511 ON/OFF MEMBRANSKI PREKIDAČ ZA CODE 29502

## Code 29503 GIMA FOETAL DOPPLER D2003 sa ekranom

Džepni fetalni dopler sa istom specifikacijom kao i code 29502 ali sa obradom brzine srčanog rada fetusa. Otkucaji srca fetusa/brzina se prikazuju na velikom ekranu uređaja dok su zvučni artefakti proizvedenog ultrazvučnog signala minimizirani.

## Code 29505 GIMA FOETAL DOPPLER D2005 sa ekranom i vodootpornom sondom

Kao i za code 29503 ali vodootporna (sonda i sam aparat).

Svi uređaji se isporučuju sa torbama i tubom provodljivog gela i uputstvom za korišćenje.



### Tehnička specifikacija: ( za codes 29502-29503-29505)

Ultrazvuk	frekvencije: 2MHz kontinuelni talasi
	Transducer: 2 kristalna uska snopa
	Radna snaga: <math><10\text{mW/mm}^2\text{ SATA}</math>
	Audio odgovor: 300Hz-1 KHz
	Fetalni srčani signali: multipoint realno vreme
	Autokorelator (samo za code 29503 i 2950)
Tasteri za kontrolu aparata:	1 taster (za aktivaciju)
	Kontrole ostalih obrtnim tasterima
Pokazatelji:	3 tastera FHR LCD ekran (code 29503,29505)
	FHR puls ikonica (code 29503,29505), ikonica za bateriju
Izvor napajanja:	baterija 9V alkalno manganska
	Dužina trajanja baterije: > 6 sati (code 29503,29505)
	> 9 sati (code 29502)
Materijal:	ABS/ Noryl
Dimenzije	150mm x 75 mm težina: 295 gr (sa transducerom)
Klasifikacija:	klasa I, Tip B- IEC 60601-I CE 0120
Garancija	1 godina
	Proizvedeno u U.K.

## Set za amnioskopiju



Da osvetlitete amnioskop tube možete koristiti GIMA lampu i Fibre Optičke kablove

### Code 29970 AMNIOKOP KOMPLET

Komplet od tri cevi za amnioskop sa zatvaračem od 200mm, prečnika 12,16 i 20 mm i klema za optički kabl. Sve cevi su graduirane u centrimetrima imaju zaobljen vrh i mogu da se sterilizuju bilo kojim metodom. Za osvetljenje amnioskop seta možete koristiti GIMA 150 izvor svetla (šifra 30818), adapter (šifra 30830), F.O. optički kabl (šifra 30818) i adapter za klemu (šifra 30840).

Code 29971 AMNIOKOP CEV 12x24x200 mm

Code 29972 AMNIOKOP CEV 16x24x200 mm

Code 29973 AMNIOKOP CEV 20x24x200 mm

Code 29975 UGAONA KLEMA ZA SVETLOSNU KONEKCIJU

## Salpingograf Schultze



### Code 29780 SALPINGOGRAF

Instrument za histerosalpingografiju i insuflaciju putem cevi. Model Prof. Gunter K.F. Schultze iz Berlina. Prizvedeno u Nemačkoj.

### Code 29784 HYSTERO ŠPRIC

#### Histerosalpingograf, standardna oprema:

Sat za histero	Histero špric 20cc	- Luer brava
Šipka za postolje	3 zamenljiva konusa (mali-srednji-veliki)	

# Fetalni monitori za jedan fetus ili blizance



12 sati beleženja podataka

LCD ekran u boji

Jake vodootporne sonde od 1 MHz

Marker događaja

Toco sonda

29531

Code 29530 MONITOR ZA POJEDINAČNI FETUS  
Code 29531 MONITOR ZA BLIZANCE - FC 1400

**Izvanredni ekranski prikaz podataka**

- 320x240 LCD monitor u boji (4.7 inch)
- FHR i automatska detekcija kretanja fetusa
- Kapacitet memorije 12 sati

**Ekstremna preciznost podataka i pristup**

- visoka preciznost i široka zona detekcije
- jednostavno beleženje podataka na ekranu
- izdržljive vodootporne sonde, 1 MHz

**Štampanje podataka**

- mogu se koristiti i standardni i A4 format papira
- može se koristiti fax papir
- velika brzina štampe (50 cm/min)

**Ostale prednosti:**

- bežični centralni monitoring do 8 ležaja (opciono)
- PC kompatibilan
- Unutrašnja baterija traje 2 sata (opciono)
- Elektroadapter 100-240 V, 50-60 Hz



29519

Podesiv stalak za 29520 i 29531

## Ekonomični monitor za pojedinačni fetus



0123

29520

Code 29520 FOETAL MONITOR GIMA FC 700

Ekonomični monitor za pojedinačni fetus

**Visoka senzitivnost ultrazvučnog doplera**


- visoka preciznost sa frekvencijom od 1 MHz
- automatska/manuelna detekcija kretanja fetusa
- auto NST (non stress test) funkcija od 10 min do 1 sata

**Štampanje podataka:**

- A4 format papir za dijagrame sa perforiranom linijom
- Fax papir može da se koristi
- Brzina štampe 1,2,3 cm/min

**Lak za korišćenje**

- jednostavan za korišćenje i podešavanje
- funkcija alarma (FHR visok-nizak)
- s/w poboljšanja moguća putem interneta

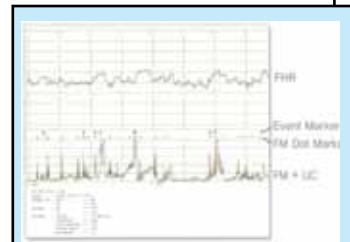

Auto-detected foetal monitor on A4 size paper

### Standardna oprema:

dopler sonde (2 za blizance)  
Toco sonda, marker događaja, gel, papir za štampač, pojasevi, uputstvo

### Tehnička specifikacija fetalnih monitora (29520,29530,29531)

#### Dopler

Ipulsni dopler  
Ultrazvučna frekvencija: 1.0 MHz  
Intenzitet: < 10mW/cm<sup>2</sup>  
FHR domet: 50-240bpm ( 1 bpm)

#### Kretanje fetusa

Izvor detekcije: ultrazvuk  
Impulsni dopler  
UC

Frekvencija: DC 0.5Hz  
Referenca (0) kontrola  
Merni rang: 0~99 jedinica

#### Štampač:

Termički rešetkasti tip  
Brzina štampe: 1,2,3 cm/min  
Funkcija za unos papira

#### Ekran

7 segmentni LED (29520)  
2 kanala (HR, UC) (29520)  
320x240 u boji LCD (29531)

#### Indikatori:

srčanog ritma sa alarmom za jačinu signala

stanje štampe no/off

AC power  
**Podešavanje:**  
alarmna viša niža vrednost  
brzine štampe, mreže na papiru  
on/off kretanja fetusa, datuma,  
vremena, kontrasta štampe

#### Napajanje:

INPUT: AC 100-240V (50/60 Hz)

#### Dimenzije:

296 Wx 305.5(H)x 92.5(D) mm

#### Težina:

približno 2.9 kg (29520),  
3.2 kg (29530-29531)

#### Eksterni link:

RS-232C: Program download

Za 29520	Za 29530-31	Oprema za fetalne monitore
29522	29528	Pakovanje papira
29523	29532	Dopler transducer-dodatni
29524	-	UC/Toco transducer do S/N FF07XXX
29529	-	UC/Toco transducer do S/N FF08XXX
-	29533	Toco transducer-dodatni
29519	29519	Stalac sa dve korpe (visina se podešava)
-	29534	Baterija NI-MH, 12V, 2600 Ma
33747	33747	AC adapter
29525	29525	Pojas

**Code 29527 Centralna stanica sa bežičnim prenosom podataka**

(PC, monitor, softer, konekcioni kit) za praćenje do 8 monitora  
Set za bežičnu konekciju za 1 monitor.



## Testovi za trudnoću

29104 





**Code 29104 kućni test trudnoće - štapičasti CE 0197**   
Delux pakovanje za štapičasti test sa uputstvom za upotrebu na više jezika.

**Code 29107 kućni test trudnoće - štapičasti CE 0197**   
Pakovanje od dva štapičasta testa sa uputstvom za upotrebu na više jezika.

**Code 29108 kućni test trudnoće - štapičasti CE 0197**   
Pakovanje od 25 štapičastih testova sa uputstvom za upotrebu.





**Code 29100 klinički test trudnoće – traka 4mm**   
Pakovanje od 50 test traka, sa uputstvom na više jezika.  
Glavne karakteristike testa:

- svaki test je zasebno pakovan
- veoma brz, detektuje trudnoću za 1 min (obično za 3 min.)
- rana detekcija, od prvog dana izostanka mesečnog perioda
- pouzdanost 99%
- senzibilnost: 25 mIU/ml
- klinički ispitano

## Menopause test





**Code 29109 MENOPAUSE TEST - štapičasti**   
Delux pakovanje sa dva štapičasta testa sa uputstvom za korišćenje i pakovanjem na više jezika. Visoko osetljiv test za detekciju FSH u urinu: osetljivost 25mIU/ml  
Klinički ispitano.

## Ovulacioni-test plodnosti


**Code 29112 OVULACIONI TEST - štapičasti**   
Delux pakovanje od 5 štapičastih testova sa uputstvom na više jezika.

**Code 29113 OVULACIONI TEST - traka 4 mm**  
Pakovanje od 50 test traka sa uputstvom na više jezika.

**Code 29114 - pakovanje od 6 testova - traka 4 mm**

## Vaginitis test komplet


Test uključuje:  
1 test + vaginalni bris štapić + tečni uzorak (pufer rastvor) u svakom pojedinačnom pakovanju + uputstvo na (Engleskom / Italijanskom)

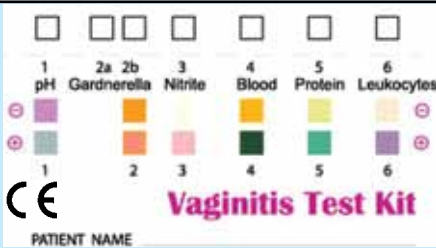

**Code 29111 VAGINITIS TEST KOMPLET**  
Jedinstven, lak za upotrebu, revolucionaran test za ginekologe. Omogućava pronalaženje uzroka upala/vaginalne infekcije za samo 10 min. Zamenjuje tradicionalne bakterijske testove koji su trajali danima a koštaju samo desetinu cene tradicionalnih. Neophodno je razblažiti uzorak vaginalnog sekreta u pufer rastvoru, pa potom naneti na reagent podlogu. Uputstvo sadrži tumačenje rezultata. Test se može koristiti za detekciju: Trihomonijaze, negativnih gram bakterija, Chlamydia, ozbiljnog bakterijskog vaginitisa. Koristi se za profesionalnu upotrebu.

## Vaginalni Ph test

**Code 29110 VAGINALNI PH TEST-pakovanje od 10 kom.**  
Brzi test za određivanje vaginalne Ph. Jedan jednostavni rutinski test kontrole vaginalne Ph za samo 1 min. kako bi se uverili da je u fiziološkim granicama (<4.5).  
Povećanje Ph vrednosti može ukazivati na promenu vaginalne flore i moguće postojanje vaginitisa.  
Test je idealan za trudnice i žene koje pate od dijabetesa.

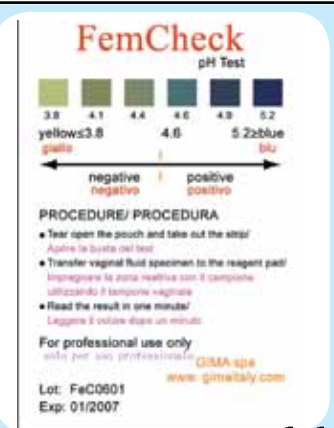

Komplet sadrži: 10 pamučnih briseva + 10 reagens podloga u svakom pojedinačnom pakovanju uključujući i uputstvo za korišćenje (Engleski + Italijanski)

## Akušerski stetoskop

Code 32501 KRATKI AKUŠERSKI STETOSKOP - bukovina

Code 32502 DUGI AKUŠERSKI STETOSKOP - bukovina

Ovi stetoskopi su ručne izrade od bukovog drveta pažljivo odabranog i sušenog najmanje tri godine.

Perfektno su obrađeni i prelakirani.


Proizvedeni u Nemačkoj.

Code 32505 PINARD STETOSKOP - aluminijumski



## AYRE špatule

CE

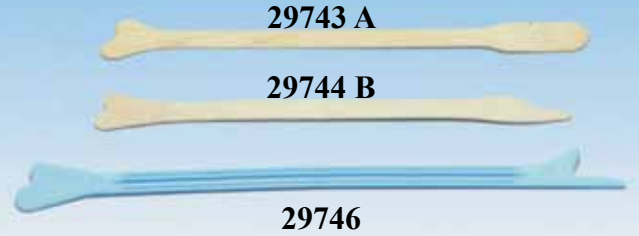


Koriste se za uzimanje ćelija iz ektocervikalnog sloja i zadnjeg fornixa pri screening programu, za prevenciju raka grlića materice.

29743 - AYRE ŠPATULA A ( drvena )  
( pakovanje od 100 komada )

29744 - AYRE ŠPATULA B ( drvena )  
( pakovanje od 100 komada )

29746 - AYRE ŠPATULA ( plastična )  
( pakovanje od 25 komada )

## Pap test komplet spreman za upotrebu

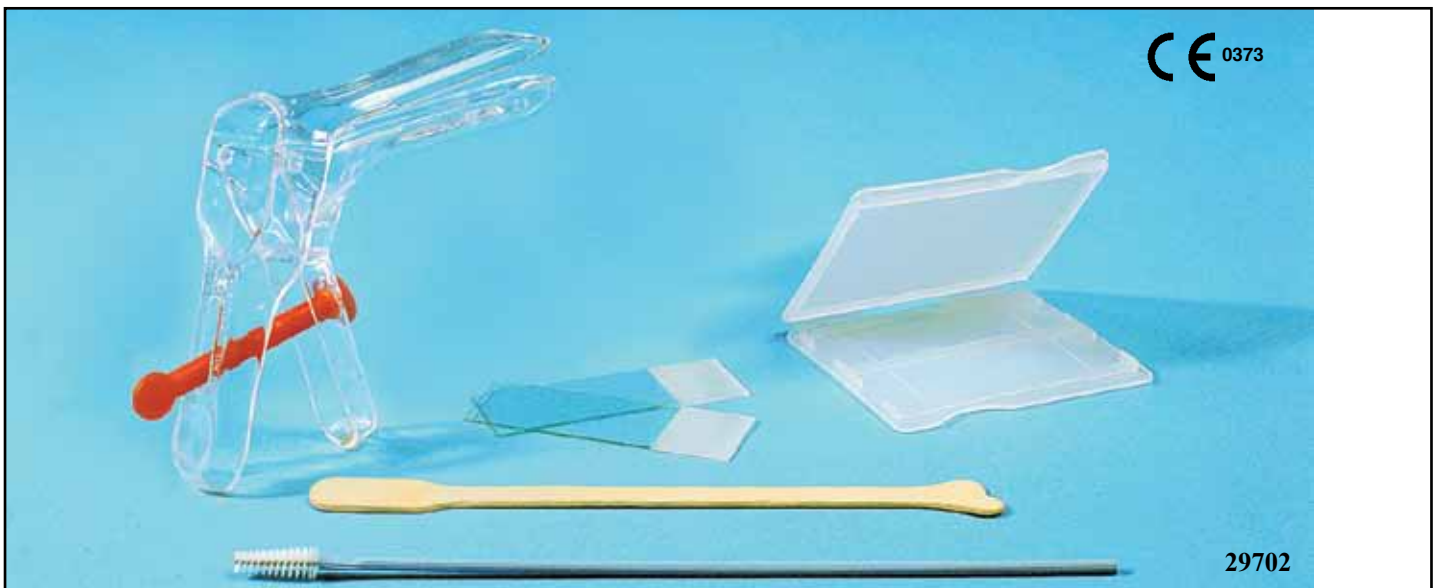


Code 29702 PAP TEST KOMPLET- sterilan - pakovanje 100.

Pap test je bezbolna metoda za utvrđivanje postojanja anomalija na ćelijama cerviksa. Omogućava rano otkrivanje raka grlića materice. Funkcionalna konfiguracija kompleta omogućava brzu upotrebu. Komplet uključuje: jednu latex rukavicu, jedan perno spekulum (srednje veličine), jednu GIMA četkicu, jednu Ayre (drvenu) spatulu, dve mikroskop pločice i jedna kutija za njih. Pojedinačno pakovano u sterilne kesice.

Proizvedeno u Italiji.

Code 29703 PAP TEST KOMPLET - sterilan - bez speculuma

# Sterilni vaginalni spekulum za jednokratnu upotrebu

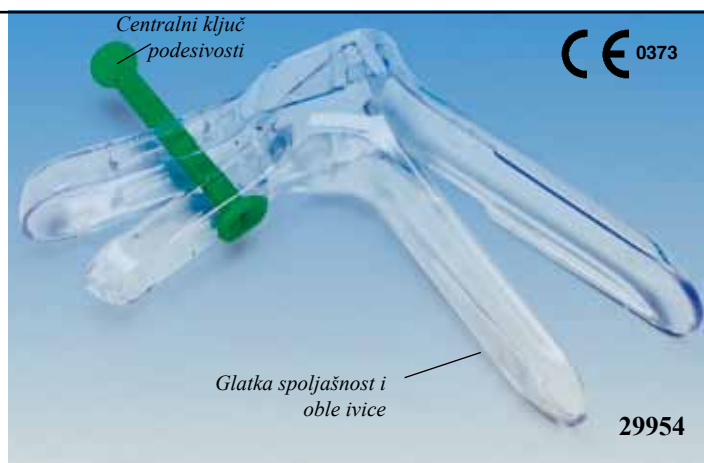

**CUSCO SPEKULUM - sa postepenim podešavanjem-sterilni**  
Spekulum za jednokratnu upotrebu sa postepenim podešavanjem putem zavrtnja. Proizveden je od najboljeg netoksičnog providnog materijala, pakuje se u zasebno providno vakum pakovanje i sterilizovan je etilen oksidom. Potvrda o sterilizaciji je specijalni broj kontrole kvaliteta na svakom pakovanju. Raspoloživ je u tri veličine koje se razlikuju po boji zavrtnja za podešavanje. Proizvedeno u Italiji.

**PERNO SPECULUM - sa centralnim klinom za podešavanje**  
Za dilaciju vaginalnog kanala kako bi se posmatrao vrat uterus. Omogućava podešavanje otvora vagine postavljanjem kraka i njihovom fiksacijom centralnim klinom. Glatka površina i zaobljeni vrhovi pomažu komforno postavljanje spekuluma. Centralni klin se može saviti nadole i tako omogućiti lako postavljanje većih instrumenata. Tri veličine se razlikuju prema boji centralnog klina. Proizvedeno u Italiji.

Code	Vaginalni spekulum za jednokratnu upotrebu - sterilni	Minimum
29950	CUSCO Spekulum- manji 85 x 20 mm	120 kom.
29951	CUSCO Spekulum- srednji 90 x 28 mm	120 kom.
29952	CUSCO Spekulum- veliki 100 x 36 mm	120 kom.

Code	Vaginalni spekulum za jednokratnu upotrebu - sterilni	Minimum
29954	PERNO Spekulum-manji Ø 20 mm	120 kom.
29955	PERNO Spekulum-srednji Ø 26 mm	120 kom.
29956	PERNO Spekulum-veliki Ø 30 mm	120 kom.

## Vaginalni spekulumi od nerđajućeg čelika - Cusco i Collin



Code	Spekulumi od nerđajućeg čelika
29770	Cusco spekulum od nerđajućeg čelika-manji 100x30mm
29771	Cusco spekulum od nerđajućeg čelika-sred. 110x34mm
29772	Cusco spekulum od nerđajućeg čelika-veliki 125x36mm
29773	Cusco spekulum od nerđajućeg čelika-virgin 110x17mm
29763	HF Cusco spekulum od nerđajućeg čelika-srednji sa izolacijom za HF aplikacije
29768	Collin spekulum od nerđajućeg čelika-srednji

Svi speculumi su zasebno pakovani u kartonske kutije.

## Gynolight



**Code 29962 GYNOLIGHT**  
Omogućava osvetljenje vaginalnog kanala. Podesan je i za spekulum sa centralnim klinom i sa bočnim zavrtnjem. Snabdeven je sa dva svetlosna izvora za dobro osvetljenje vaginalnog kanala, a onaj viši izvor korisnik može da podešava. Lako se postavlja i skida zahvaljujući bočnim oprugama. Gynolight ne dolazi u kontakt sa sluznicom. Steriliše se hladnom sterilizacijom. Proizvedeno u Italiji.

Dostupno u kesici sa dve / 1.5 V baterije


## Lubrikantni gel

**Code 29960 LUBRIGIMA-250 ml**  
Za lakše postavljanje instrumenata tokom ginekološkog pregleda. Poseban sastav gela i visoka providnost ne menjaju vizuelnu sliku kada se koriste optički aparati. Ne sadrži spermicid, ne masti i ne ostavlja fleke. Ima kiseli Ph i dobru elektroprovodljivost. Rastvorljiv je u vodi. Koža ga dobro absorbuje, ne izaziva iritaciju sluzokože. Proizvedeno u Italiji.



Min porudžbina: 6 komada.

# WALLACH PAPETTE

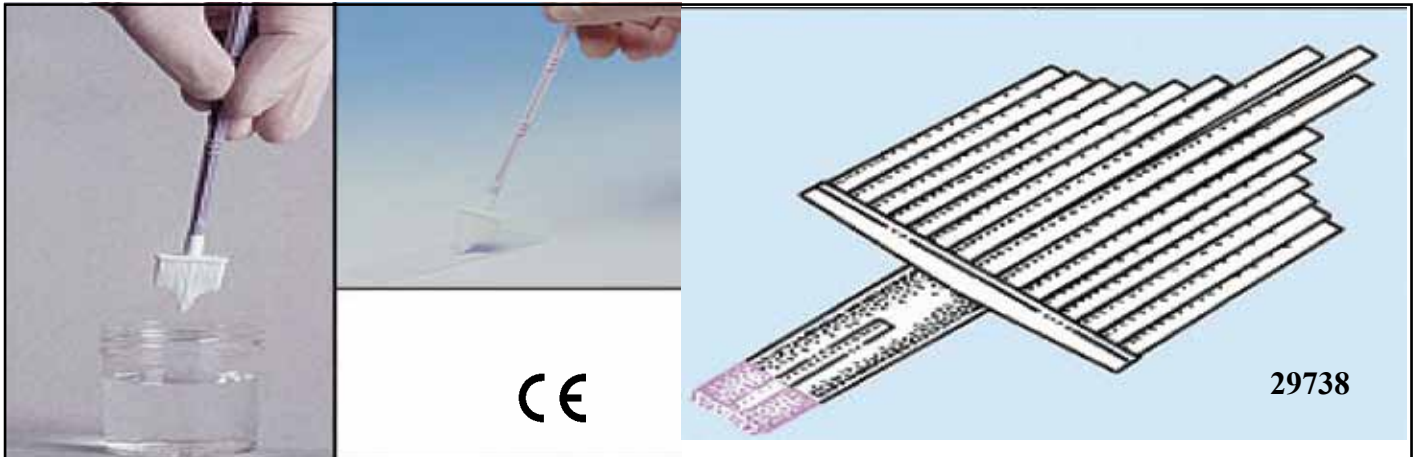

## Code 29738 WALLACH PAPETTE

Logičan izbor za standardni pap test kao i za novu tehnologiju baziranu na fluidu.

Sa WALLACH PAPETOM uzorak uzimate jednostavnim okretanjem četkice koja kupi endocervikalne i ektocervikalne ćelije, uključujući i prelaznu zonu, uz minimalnu traumatizaciju tkiva. Metoda je vrlo jednostavna i eliminiše potrebu za dvostepenim uzimanjem uzoraka, četkicom i špatulom. Pakovanje od 100 komada.

**Code 11000 WALLACH PAPETTE - mini box** - pakovanje od 20 komada

# Četkice za uzimanje cervikalnog brisa



**Code 29739 ČETKICA - konusna - kesica od 25 kom.**

**Code 29740 ČETKICA - konusna - kutija od 400 kom.**

Ove endocervikalne četkice za jednokratnu upotrebu koriste se efikasno u prikupljanju uzoraka sa vulvalne, endocervikalne, i površine sluzokože nosa za citološka/mikrobiološka ispitivanja. Nisu sterilne. Pakovane u plastične kesice po 25 komada, i kutije od 400 komada.

**Code 29742 ČETKICA-konusna-sterilna**

Kao i proizvod pod šifrom 29740, pojedinačno pakovane u sterilne kesice. Oba proizvoda proizvedena u Italiji.

**Pakovanje: 500 kom.**

# Sprej za citološku fiksaciju i dodatna oprema

## Code 29778 GIMAFIX SPREJ ZA CITOLOŠKU FIKSACIJU

Fikser za citologiju. Sastav: isopropanole, poly-ethyleglycole. Ne sadrži supstance destruktivne za ozon. Boca od 250 cc.

## Code 29775 MIKROSKOPSKE PLOČICE


Dimenzija 76 x 26 mm, debljine 1.2mm, proizvedene od stakla sa ispoliranim ivicama, peskiranog.

## Code 29776 KUTIJA ZA PLOČICE

Plastična, providna kutija za čuvanje najviše 3 pločice.



## Set za histerografiju i SIFT špricevi koji se zavrću

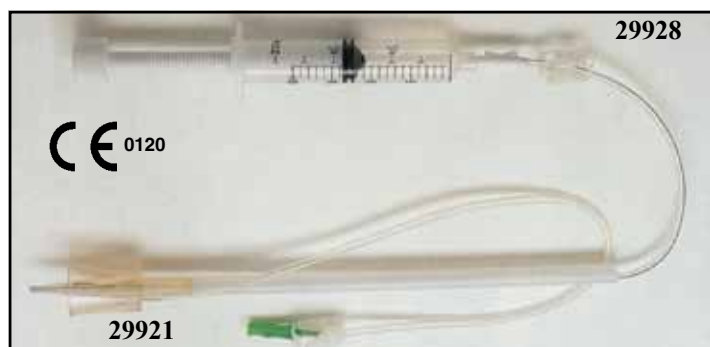

Code	KUPICE ZA HISTEROGRAFIJU - ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU - STERILNE	Minimum
29920	Kupica 25 mm	10 kom.
29921	Kupica 30 mm	10 kom.
29922	Kupica 35 mm	10 kom.
29923	Konektor za kupicu-sterilni	10 kom.
29928	SIFT špric koji se zavrće za kupicu	10 kom.

### KUPICA ZA HISTEROGRAFIJU

Uređaj se sastoji od čvrste providne zašiljene kupice sa centralnom koničnom canilom.

Opremljen je sa 25 cm dugim fleksibilnim manipulatorom koji je priključen kupici i dve cevi sa stezaljkama. Jedna od njih obezbeđuje vakum dok druga injektuje kontrast. Odlično prijanjanje za cervix, osigurano je zašiljenim vrhom kupice i vakumom. Sukciona cannula i kupica su radiotransparentne i omogućavaju kontrolu prednje površine endocerviksa.

Radiolog prednje površine može da manipulira na udaljenosti od radioaktivnog polja istovremeno vršeći imobilizaciju uterusu.

### SIFT ŠPRIC KOJI SE ZAVRĆE

Okretanjem šprica koji ima navoj omogućeno je lako i pravilno injektovanje kontrastnog medijuma.

Ako se koristi kupica konektor nije potreban za ovaj naš SIFT špric.

## Pesar za uterusni prolaps Igle za amniocentezu




Code	Gumeni pesari
29963	Gumeni pesar Ø 60 mm
29964	Gumeni pesar Ø 65 mm
29965	Gumeni pesar Ø 70 mm
29966	Gumeni pesar Ø 75 mm
29967	Gumeni pesar Ø 80 mm
29968	Gumeni pesar Ø 85 mm

Za transabdominalno uzorkovanje amnijske tečnosti za prenatalno dijagnostifikovanje genetskog oboljenja fetusa. Takođe se koristi u citogenetici i biohemijskim istraživanjima. Precizno zaoštrana igla omogućava laku i netraumatsku penetraciju. Igla je opremljena tipsom koja omogućava ultrazvučno navođenje insercije. Bojom su kodirani kako bi se lakše identifikovala veličina igala. Igle imaju podesiv stoper koji određuje dubinu insercije i konektor koji omogućava skupljanje amnijske tečnosti putem šprica. Proizvedeno u Italiji.

Code	Igle za amniocentezu - sterilne
29630	Igla 20 G x 100 mm
29631	Igla 20 G x 120 mm
29632	Igla 20 G x 150 mm
29633	Igla 20 G x 180 mm
29634	Igla 21 G x 120 mm

## Perforator membrane

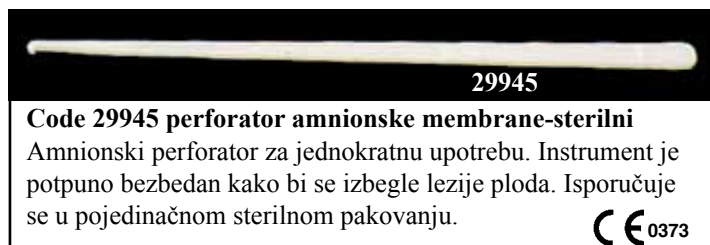

Amnijski perforator za jednokratnu upotrebu. Instrument je potpuno bezbedan kako bi se izbegle lezije ploda. Isporučuje se u pojedinačnom sterilnom pakovanju. CE 0373

Code	HISTEROMETAR - ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU - STERILAN	Minimum
29930	Histerometar CH 10	25 kom.
29931	Histerometar CH 12	25 kom.
29932	Histerometar CH 14	25 kom.



## Stezaljka za pupčanu vrpцу



Code 29943 - bezbedna stezaljka za pupčanu vrpцу - sterilna

Stezaljka za pupčanu vrpцу za jednokratnu upotrebu koja omogućava dobro stezanje vrpce i sprečava njeno izvlačenje. Pojedinačno pakovane u dupli celofan (nylon/polietilene) i med. papir kako bi se osigurala higijenska bezbednost za korisnika. Sterilizovano ethylene oxidom. Proizvedeno u Italiji.

# „Karman“ i „Berkeley“ tip intrauterine usisne kirete

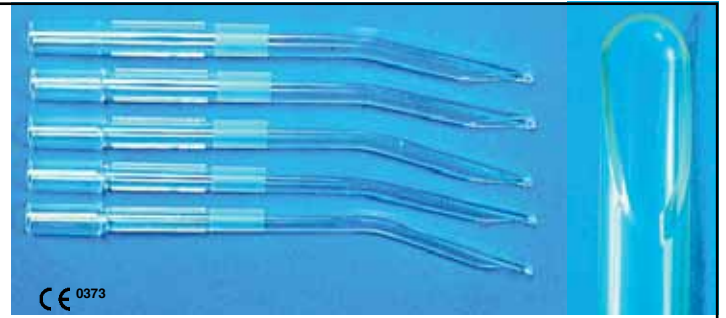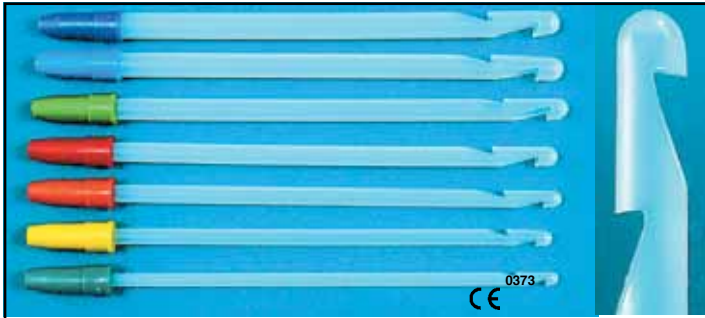

Code	„KARMAN“ TIP KIRETA FLEKSIBILNE - jednokratna upotreba - STERILNE	Minimum
29860	Karman kirete N° 6 - 6 mm x 24 cm	10 kom.
29861	Karman kirete N° 7 - 7 mm x 24 cm	10 kom.
29862	Karman kirete N° 8 - 8 mm x 24 cm	10 kom.
29863	Karman kirete N° 9 - 9 mm x 24 cm	10 kom.
29864	Karman kirete N° 10 - 10 mm x 24 cm	10 kom.
29865	Karman kirete N° 11 - 11 mm x 24 cm	10 kom.
29866	Karman kirete N° 12 - 12 mm x 24 cm	10 kom.


Code	„BERKELEY“ TIP KIRETA - zakrivljene čvrste-za jednokratnu upotrebu - STERILNE	Minimum
29870	Berkeley kirete N° 7 - Ø 7 mm x 18.5 cm	10 kom.
29871	Berkeley kirete N° 8 - Ø 8 mm x 18.5 cm	10 kom.
29872	Berkeley kirete N° 9 - Ø 9 mm x 18.5 cm	10 kom.
29873	Berkeley kirete N° 10 - Ø 10 mm x 18.5 cm	10 kom.
29874	Berkeley kirete N° 11 - Ø 11 mm x 18.5 cm	10 kom.
29875	Berkeley kirete N° 12 - Ø 12 mm x 18.5 cm	10 kom.

## Code 29918 ŠPRIC ZA SUKCIJU – jednosmerni, samoblokirajući



Poseban špic sa adapterom podesnim za korišćenje uz Karman i Berkeley kirete ili ostalih brendova. Jednosmerni, samoblokirajući sa osiguračem. Obezbeđuju laku i sigurnu upotrebu. Za jednokratnu upotrebu, sterilni, 60 ml zapremine.  
**Min porudžbina: 10 kom.**

# Kanile za endometrijalno uzorkovanje

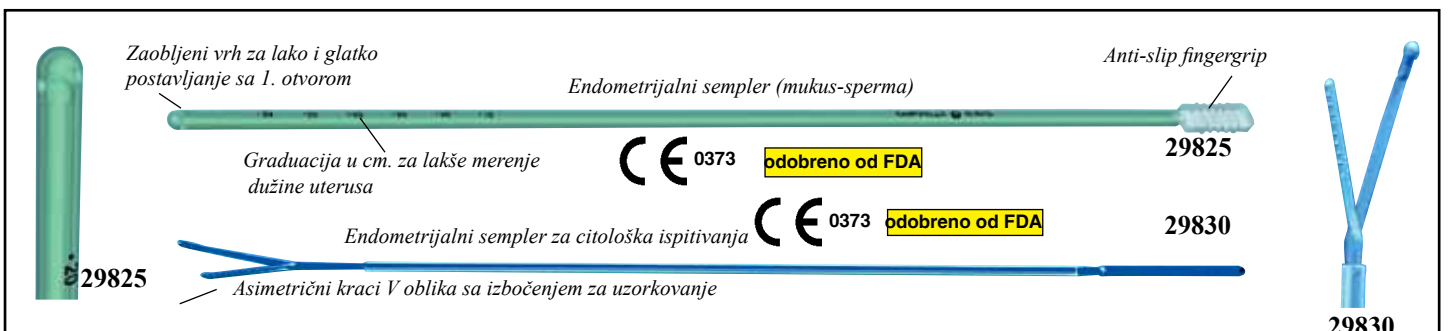

## Code 29825 RAMPIPELLA 1 otvor, za jednokratnu upotrebu - sterilna

Za endometrijalno histološko uzorkovanje i uzorkovanje sperme u postkoitalnom testu. Omogućava bezbolan i jednostavan rutinski skrining endometrijuma izbegavajući dilataciju i trakciju vrata uterusa. Eksterni Ø 3.1 mm – dužina 24.5 cm  
Jednokratna upotreba, sterilna. Proizvedeno u Italiji.

## Code 29830 CERVIRAM- za jednokratnu upotrebu, sterilna

Za citološko endometrijalno uzorkovanje. Omogućava bezbolan i jednostavan rutinski skrining endometrijuma izbegavajući dilataciju i trakciju vrata uterusa. Spoljašnja obloga prekriva cev koja se završava asimeričnim V oblikom kraka na vrhu. Eksterni Ø 3.5 mm – dužina 26 cm.

# Silikonska kupa za sukciju


## Code 29980 SILIKONSKA USISNA KUPA

Ø 60 x 210 mm

## Code 29981 SILIKONSKA USISNA KUPA

Ø 70 x 210 mm

Napravljeno od silikona za medicinsku upotrebu.

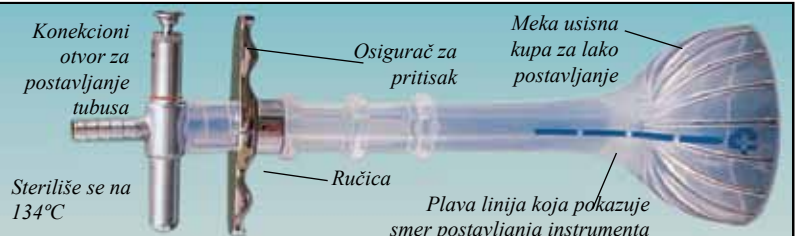



# GIMA Kolposkop

## Code 29600 COLPY-GIMA KOLPOSKOP

Jednostavan za korišćenje halogen kolposkop na stalku sa pet nožica sa točkicama.

### Tehnička specifikacija:

Uveličavajući: 6.2X sa standardnim 10X okularom  
 Optički sistem: stereo sa podešavanjem međuzeničkog razmaka glavom na 45°  
 Osvetljenje: halogena sijalica 12V-12W  
 Radna udaljenost: 26 cm  
 Radna voltaža: 230V (po narudžbi 115V)  
 Standard: Klasa I Tip B – IEC 601-1 CE 93/42/EEC, Proizvedeno u Italiji

## Code 29601 KAMERA KONEKTOR

Za konektovanje kamere sa standardnim adapterom na kolposkop.

## Code 29602 - kamera za kolposkop

## Code 29610 - softver za kolposkop

### Tehnička specifikacija:

Kamera: 1/3 CCD  
 Rezolucija: 480 linija  
 Dimenzije: 85x53x145mm  
 (glava 36x40x30mm)  
 Napajanje: 230V - 50/60 Hz



Podesiva visina

CE

29600



# Video kolposkop sistem

## Code 29605 NETSCOPE - KOLPOSKOP-8X

Sve u jednom sistemu za primenu videokolposkopije: Sistem sadrži CCD kameru sa integrisanim 150W svetlosnim izvorom, optički kabl, ergonomski držač i kolposkopsku sondu.

Osnovne karakteristike:

### - izvrstan kvalitet slike

Mikroprocesor kontroliše jasnoću, rezolucija od 440000 piksela daje ostru i jasnu sliku. Optički deo proizveden u Nemačkoj.

### - lak za korišćenje i rukovanje

Sonda je ergonomski dizajnirana i stalak omogućuje veoma lako rukovanje aparatom.

### - visoka uveličavajuća sposobnost

Fino podešavanje pri različitim aplikacijama omogućava taster za fokus, bez potrebe promene sočiva.

### - fleksibilnost

Uređaj može da se pretvori u videodermatoskop ili videotoskop jednostavno zamenom sondi. Jednostavna zamena sijalice kroz vrata.

## Code 29610 softver za kolposkop

Ovaj softver omogućava čuvanje slika i podataka u bazi podataka računara kao i njihovo štampanje (samo na Engleskom jeziku)

## Code 72705 LCD medical monitor - 15"- ravan ekran

Code 29606 pokretni stalak - Na njega se lako postavlja Netscope ili bilo koji tip monitora ravnog ekrana kompatibilnih sa VESA 75 standard.

Code 29607 fleksibilna drška sa stalkom - Ova drška je fiksirana za stalak i omogućava stavljanje sonde u fiksni i stabilan položaj.




Opcija zamrzavanja slike omogućava zamrzavanje 4 slike na ekranu i istovremeno osvrn na jednu od njih u punoj veličini

Ergonomski oblik

Kolposkopska sonda

29607

Fleksibilna drška

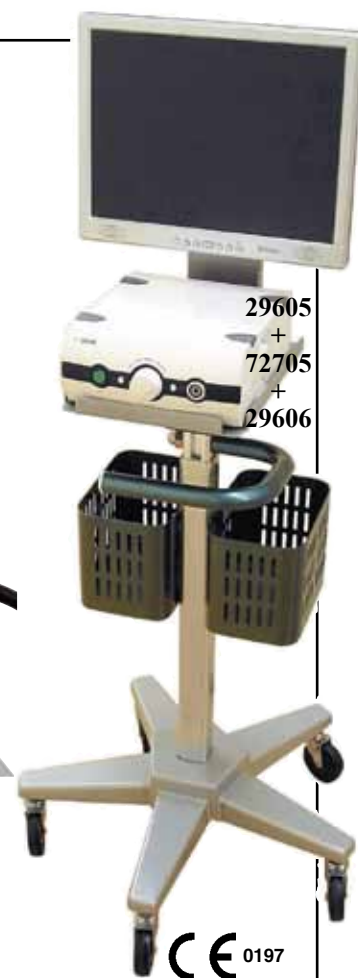

29605  
+  
72705  
+  
29606

CE 0197

### Tehnička specifikacija Netscope:

Kamera senzor:	1/3 CCD Sony	Dužina kabla:	200 mm
Horizontalna rezolucija:	480 linija	Min iluminacija:	0.5 lux
Proizvodi digitalni signal		Izvor napajanja:	90-250V-0-60Hz
ACG beli balans:	AUTO/FIXED	Dimenzije aparata:	210x92x240mm
Intenzitet osvetljenja:	podešavajući 0-150W	Težina:	3 kg
Video izlaz:	Y/C (S-VHS), komposit (BNC)	Proizvedeno u Nemačkoj.	

### Tehnička specifikacija šifra monitora 72705:

Displej:	15"/38,1 cm TFT active matrix
Aktivna zona:	304,1 x 28 mm
Rezolucija:	1024x784 (XGA)
Dimenzije:	375x356x210 mm

# Videodermatoskop



20x uveličavnje sa 15" monitorom.



## Code 29608 VIDEODERMATOSKOP SONDA - 20X

Ova sonda dodata na aparat šifra 29605 pretvara sistem u video dermatoskop. Proizvedeno u Nemačkoj.

# Videotoskop



## Code 29609 VIDEOOTOSKOP SONDA - Ø 4 mm-0°

Ova sonda dodata na aparat šifra 29605 pretvara sistem u videotoskop. Proizvedeno u Nemačkoj.

# Rektoskopi, proktoskopi, anoskopi za jednokratnu upotrebu

**Code 25953 F.O. svetleća glava**

Ova se glava dobro postavlja i osvetljava anoskope, rektoskope, proctoskope GIMA, HEINE, WELCH, ALLYN, GPS proizvođača. Može se konektovati na svetlosni izvor fiber kablom ili na LED sistem osvetljenja.

**Code 25950 ANOSKOP ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU - sterilizovan**

Dužine 10 cm, sa malom sondom prečnika 17 mm, pogodan za lečenje hemoroida.

**Min. porudžba: pakovanje od 60 kom.**

**Code 25951 PROKTOSKOP ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU - sterilizovan**


Dužine 16 cm, sa malom sondom prečnika 17mm

**Min. porudžba: pakovanje od 50 kom.**

**Code 25952 REKTOSKOP ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU - sterilizovan**

Dužine 25 cm, sa malom sondom prečnika 17 mm, skalom u cm, osvetljenjem koje je udaljeno od izlaza zahvaljujući crnoj neprozirnoj cevi koja se nalazi unutar prozirnog tela instrumenta i omogućava osvetljenje bez senki.

**Min. porudžba: pakovanje od 50 kom.**

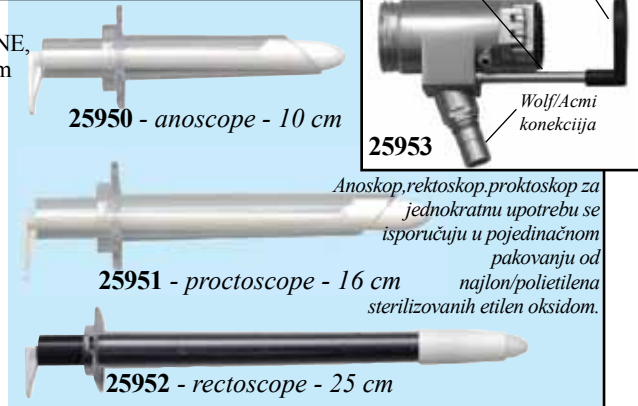
**SISTEMI ZA OSVETLJENJE**

Svi proizvodi na ovoj stranici opremljeni su Acme/Wolf svetlosnom konekcijom. Da bi se omogućilo osvetljenje potrebno je kupiti Wolf adapter (30841), optički kabl (30818-30826), adapter za napajanje (30830) i izvor svetla (30801-30802).

Prilikom upotrebe instrumenti mogu da se okače, za šta predlažemo držače koji mogu da se postave između instrumenta i optičkog kabla.

**Code 30798 ručka za ano/prokto/rektoskop**

Alternativno možete izabrati ekonomičnije rešenje za osvetljavanje uključujući i ručku.

**Code 30799 držač za osvetljenje 6.0 VOLT - halogena sijalica**

Funkcioniše kao nezavistan svetlosni izvor za optički kabl.

## Anoskopi, proktoskopi sa fiber-optičkim kablom

**F.O. ANOSCOPES**

**F.O. PROCTOSCOPE**

Sa 2.0X uveličavajućim sočivom

Code	F.O. ANOSKOPI-PROKTOSKOPI
29400	F.O. anoskop Ø15x70mm-sa zapušaćem-Wolf/Acme konektor
29401	F.O. anoskop Ø20x70mm-sa zapušaćem-Wolf/Acme
29402	F.O. anoskop Ø25x70mm-sa zapušaćem-Wolf/Acme
29403	Set 3 F.O. anoskopa sa Wolf i Storz konektorom u kutiji
29405	F.O. proktoskop Ø20x130mm - sa zapušaćem sa 2.0x
30844	Storz adapter (za konekt. F.O. ano/procto sa Storz kablom)

## Sigmoidoskopi sa optičkim kablom

Code	F.O. SIGMOIDOSKOPI SA 2.0X UVELIČAVAJUĆIM OBRTNIM SOČIVIMA
29410	F.O. Sigmoidoskop - 12x200mm sa Wolf/Acme adapterom
29411	F.O. Sigmoidoskop - 16x250mm sa Wolf/Acme adapterom
29412	F.O. Sigmoidoskop - 21x200mm sa Wolf/Acme adapterom
29413	F.O. Sigmoidoskop - 21x250mm sa Wolf/Acme adapterom
29414	F.O. Sigmoidoskop - 21x300mm sa Wolf/Acme adapterom
30844	Storz adapter (za konektovanje sigmoidoskopa sa Storz kablom)

Code	S/S oprema za F.O. anoskope, proktoskope, sigmoidoskope
29420	Držač za klešta za biopsiju
29421	Klešta za biopsiju 3.5x8 mm kraci za čupanje - 420 mm
29422	Klešta za biopsiju 4mm-kraci za sečenje - 420 mm
29425	Klešta za pridržavanje sundera - 400 mm
29426	Tubus za sukciju - 400 mm
29427	Insuflator

**Code 29418 LLOYD-DAVIES sigmoidoskop komplet**

Sigmoidoskop komplet se sastoji od jedne svetlosne komore, sa Acme/Wolf adapterom, jednom cevi za odrasle Ø 20x300 mm, jednom cevi za veću decu Ø 16x250 mm i jednom cevi za manju decu Ø 10x75 mm, upakovanim u meke kesice. Za osvetljenje, mogu se koristiti držač za osvetljenje (šifra 30799) ili Gima svetlosno napajanje (30801), adaptor za napajanje (30830), optički kabl (30818) i adapter (30841).